


歯科メタルセラミック修復物の試験方法

正 誤 票

区分	位置	正
本体	図 6	正しい図を下記に示す。

平成 18 年 11 月 1 日作成

(正の図)

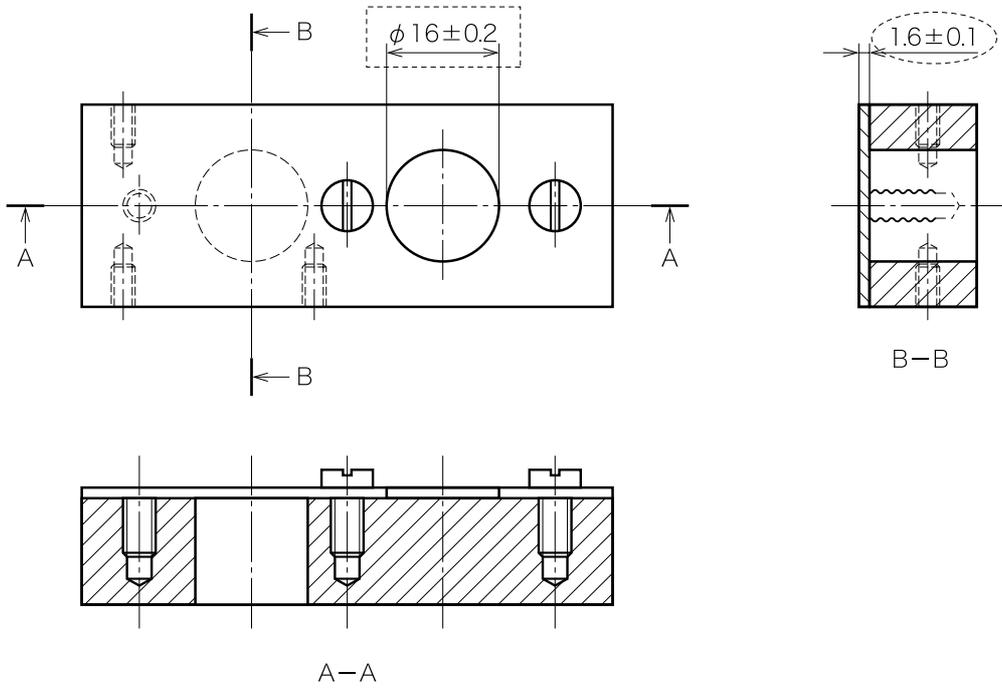

($\phi 16 \pm 0.2$ 及び 1.6 ± 0.1 は訂正箇所を示す。 1.6 ± 0.1 は、平成 18 年 9 月 1 日に作成した正誤票に対する訂正。)