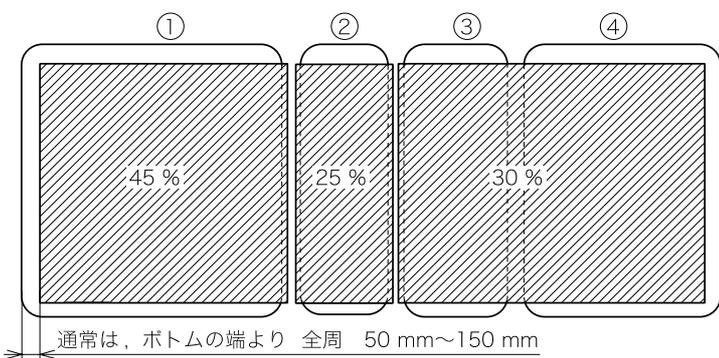
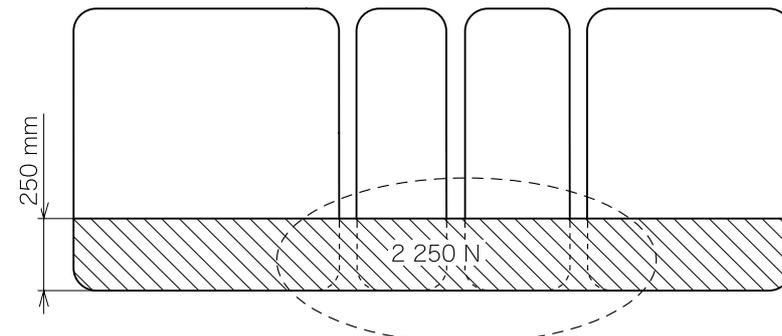


在宅用電動介護用ベッド

正 誤 票

区分	位置	正
本体	図 7	<p style="text-align: center;">[正の図]</p>  <p style="text-align: right;">① 背ボトム ② 腰ボトム ③ ひざボトム ④ 脚ボトム</p> <p>通常は、ボトムの端より 全周 50 mm~150 mm</p> <p>備考 パーセント (%) は、8.1 a) で定めた荷重の割合</p>
	図 8	<p style="text-align: center;">[正の図]</p>  <p>250 mm</p> <p>2 250 N</p> <p>() 訂正箇所</p>